

Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/18/2019

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedzi na pytania

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem do SP ZOZ w Słupcy.”

1) Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymian oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odp. Przeglądy okresowe w okresie gwarancji należy wliczyć w cenę oferty.

2) Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odp. Przeglądy okresowe w okresie gwarancji należy wliczyć w cenę oferty.

3) Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odp. Przeglądy okresowe w okresie gwarancji należy wliczyć w cenę oferty.

4) Jeśli Zamawiający pokrywa koszty przeglądów, prosimy o potwierdzenie, iż również na własny koszt dostarczy oraz odbierze ambulans.

Odp. Zamawiający nie pokrywa kosztów przeglądów.

5) Prosimy o potwierdzenie, iż koszty serwisu pogwarancyjnego ponosi Zamawiający.

Odp. Tak.

6) Dotyczy eksploatacji: prosimy o podanie szacunkowego zakładanego przebiegu rocznego.

Odp. Szacunkowy przebieg roczny ambulansu to 25 tys. km.

7) Prosimy o określenie marki i modelu radiotelefonu przewoźnego jaki będzie montowany w ambulansie abyśmy mogli przygotować odpowiedni uchwyt.

Odp. Radiotelefon przewoźny Motorola DM3601.

8) Prosimy o określenie marki i modelu tabletu jaki będzie montowany w ambulansie abyśmy mogli przygotować odpowiednią stację dokującą.

Odp. Terminal mobilny Twinhead Durabook R16.



9) Prosimy o określenie marki i modelu drukarka jaka będzie montowana w ambulansie abyśmy mogli przygotować odpowiedni uchwyt.

Odp. Drukarka mobilna HP CN551A.

10) Prosimy o określenie marki i modelu modułu GPS jaki będzie montowany w ambulansie abyśmy mogli przygotować odpowiednią instalację.

Odp. Moduł GPS Teltonika FM3300.

11) W związku z udostępnieniem i wymaganiem producenta do nowo produkowanych pojazdów ciężarowych kat N1 przeznaczonych w końcowym etapie produkcji na ambulans sanitarny kat M1, specjalnej wersji oprogramowania dedykowanej wyłącznie dla pojazdów specjalnych tj. takich które w końcowym etapie produkcji przeznaczone są np. na ambulanse i są homologowane jako ambulans sanitarny zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający po rejestracji pojazdu, udostępni Wykonawcy ambulansu pojazd na czas max do 30 dni roboczych od zarejestrowania ambulansu, w celu zainstalowania w/w oprogramowania na koszt i ryzyko Wykonawcy?.

Uzasadnienie : Nowe oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy ambulansu dedykowane jest wyłącznie dla pojazdów które w końcowej fazie produkcji stają się pojazdami specjalnymi. Takie oprogramowanie nie jest dostępne dla pojazdów kategorii N1 czyli ciężarowych a więc nie można go zainstalować na etapie produkcji pojazdu bazowego .

Odp. Zgodnie z SIWZ.

12) Czy Zamawiający dopuści realizację do 31.03.2020?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

13) Czy w razie przedłużenia przez Ministerstwo terminu dostawy ambulansu, Zamawiający zgodzi się aneksować umowę w zakresie późniejszego terminu dostawy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

14) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy ambulansu do końca 2019 roku?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

15) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbiór pojazdu w siedzibie producenta ambulansu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

16) Prosimy o odpowiedź czy zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania wadium ?

Odp. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

17) Czy Zamawiający wymaga przetwornicy w ambulansie czyli dostępności prądu w gniazdach 230 V podczas jazdy?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

18) Prosimy o zmniejszenie kar za zwłokę w dostawie ambulansu do 0,1% wartości umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

19) W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze główne firmy Medirol model Clinic Extero zgodne z aktualnymi normami ambulansowymi obowiązującymi w Polsce tj. **PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015**, charakteryzujące się poniższymi parametrami:

Nosze główne rozłączne

- Wykonane z materiału odpornego na korozję, malowanego metodą proszkową
- Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
- Przystosowane do prowadzenia reanimacji
- Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni
- Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiającą odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak.
- Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy
- Rama o przekroju okrągłym, dzięki czemu mniej jest podatna na uszkodzenia na skutek uderzeń i otarcia
- Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbującej krwi

- i płynów, odporny na środki dezynfekujące
- Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi
- Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy
- Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy
- Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi
- Waga noszy 22 kg, zgodne z wymogami normy PN EN 1865
- Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy
- Obciążenie dopuszczalne 250 kg

Transporter noszy głównych rozłącznych

- Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę – pełna kontrola w trakcie wprowadzania i wyprowadzania noszy z/do ambulansu uruchamiany dźwignią blokady
- Szybki i łatwy system połączenia z noszami
- Stała długość goleni noszy, wysokość załadunku 70 cm
- Zintegrowane z ramą uchwyty, dzięki czemu zabezpieczony został dostęp do przycisków blokady składania goleni, co razem z podwójnym skokiem blokady składania goleni stanowi zabezpieczenie przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół
- Regulacja wysokości w 7 poziomach – system ALS Automatyczny System Blokujący umożliwiający podniesienie noszy bez potrzeby uruchamiania żadnych blokad, dźwigni zamiast opisanego systemu wspomaganie sprężynami gazowymi
- Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy
- Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na trzech poziomach pochylenia
- Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360°, 2 kółka wyposażone w hamulce
- Wszystkie kółka jezdne o średnicy 200mm, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem w budynkach i poza nimi, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost uruchamianą dźwignią (kółka do jazdy na wprost blokują się automatycznie po wciśnięciu blokady)
- Obciążenie dopuszczalne transportera 275 kg
- Uchwyty zintegrowane z ramą transportera, bez dodatkowych rączek
- Waga transportera 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865
- Mocowanie transportera do ławety ambulansu zgodne z wymogami normy PN EN 1789
- Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją
- Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy
- Rama o przekroju okrągłym
- Tabliczka znamionowa informująca o dacie kolejnego przeglądu

Odp. Zamawiający dopuszcza.

20) W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski z dnia 12 września 2018) tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych?

Odp. Tak.

21) W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów do noszy głównych tj. deklaracji zgodności i certyfikatu zgodności wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnych z najnowszymi aktualnymi normami tj. odpowiednio **PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A2:2015?**

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. **Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm,** dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może

potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko **niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865**
Odp. Tak.

22) W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje aby dostarczone nosze wyposażone były w kółka o średnicy co najmniej 155 mm, wszystkie skrętne o 360 stopni?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

23) Dotyczy Ssak akumulatorowo – sieciowy:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nowy model ssaka Accuvac Lite będący następcą ssaka Accuvac Basic, wyposażony w filtry bakteryjne jednorazowego użytku, o wadze ok. 5,6 kg, temperaturze pracy od -5° C do + 50° C, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

24) Dotyczy: Defibrylator przenośny

Pytanie 1.

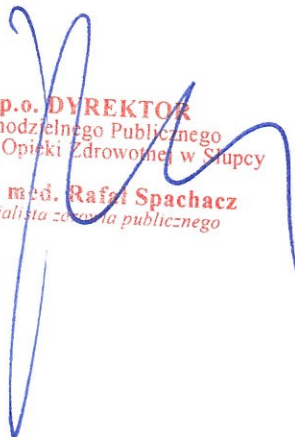
Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności defibrylator przenośny, cenionego europejskiego producenta o poniższych parametrach:

- Ładowanie akumulatorów po każdorazowym wpięciu w uchwyt karetkowy 12 V DC bez konieczności stosowania ładowarki 230 V czy 12 V.
- Czas pracy urządzenia na 3 akumulatorach – 10 godzin monitorowania lub 428 defibrylacji maksymalną energią
- Autotest wykonywany po każdorazowym włączeniu urządzenia
- Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji bez przycisku drukowania. Wydruk następuje po każdorazowej defibrylacji
- Częstotliwość stymulacji do 150 impulsów na minutę
- Pamięć w postaci karty CF do zapisu wszystkich rejestrowanych danych

Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.


p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
dr n. med. Rafał Spachacz
specjalista zlecenia publicznego

Sporządziła: Estera Urbaniak

**Samodzielne stanowisko
ds. zamówień publicznych**


Estera Urbaniak